FUJIIRYOKI

アルカリイオン整水器S2
FWH-10000

健康を考える私は、
トレビの水を選ぶ。

TREVI + $H_2$

トレビ水素プラス

FWH-10000

水を選べば
毎日の暮らしが
健やかになる

## フジ医療器は考えます。
## 食の安全と健康的な生活のために

フジ医療器は1954年に創業し、美と健康の総合メーカーとして品質にこだわり続けています。その半数近い年月を、アルカリイオン整水器の販売というカタチで、食の安全と健康的な生活を守る「水」を提供してまいりました。「健康」という観点から食生活の改善が見直されています。飲む水として唯一、医療機器として認証されているアルカリイオン整水器で毎日の暮らしにトレビをプラスしませんか。

水を賢く選んで

# 健康なカラダと、安心の暮らしを。

アルカリイオン水とは、水の電気分解によって発生する水素を豊富に含んだアルカリ性の電解水です。
あなたのご家庭にも健康のベースとなる飲む水、料理に使う水、暮らしを清潔に保つ水、毎日の暮らしをワンランク快適にする11種類の水をお届けします。

## アルカリイオン水の使用目的、または効果

### 胃腸症状の改善に働きかけます。

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

※本カタログでは生成される水の名称として、「アルカリイオン水」・「酸性水」を使用しています。これらはJIS T 2004（家庭用電解水生成器）で用いられる「アルカリ性電解水」・「酸性電解水」に相当します。

# 健康と安心は水を使い分けることから

浄水　ミルク・薬を飲む水

アルカリイオン水　お料理に最適な水

酸性水　肌にやさしい水

衛生水　洗浄除菌できる水

## 選べる11種類の水とpH値目安

ボタンを押すだけの簡単操作で水素たっぷり、暮らしに最適な11種類の水を選ぶことができます。

| 飲用水 | 飲み始め | 飲み慣れ | 日常飲用 | 機能水 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浄水 | アルカリ1 | アルカリ2 | アルカリ3 | 衛生水 | 酸性水 | 強アルカリ |
| pH8.5 / 水素プラス pH8.5 | | pH9.0 / 水素プラス pH9.0 | pH9.5 / 水素プラス pH9.5 | pH2.5 | pH5.5 | pH10.5 / 水素プラス pH10.5 |
| 薬・サプリ | 初めて飲む方 | 米研ぎ・炊飯 | お茶・お料理 | 洗浄除菌 | 洗顔 | アク抜き・野菜洗い |

## 水素たっぷり！しっかり電解

電解しにくい水質でもしっかり電解

**水素プラスボタン**

**水素濃度 約4倍**※

※流量2.5L/分（定格流量）でpH9.5合成水使用時（JIS T 2004に基づく合成水）通常モードと水素プラスモード比較。水質により異なります。

pHを自動で一定に保つ賢い機能

**pH自動コントロール機能**

流量にかかわらずpHを自動で一定に調整する機能を搭載。

※アルカリ 1.2.3の場合。

## 使いやすさにこだわった機能

野菜洗いや生活の中でもパワフルに使える！

**最大吐水量 毎分約 5.5L**

手間要らず！定期的に電極メンテナンス！

**自動クリーニング機能**

シンクまわりに置きやすい！

**デリバリーパイプ65cm**




## 業界トップクラス※の節水能力と低コストで環境にも家計にもやさしい

### もったいない排水（酸性水）は、ほんの少し

わずかな排水でたっぷりのアルカリイオン水を生成できます。
生成水・排水の流量比率は**業界トップクラス※の19：1**

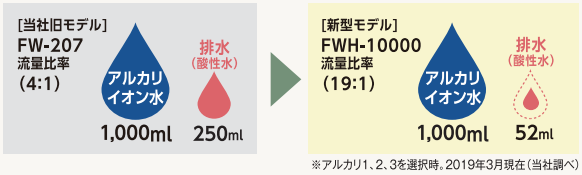


※アルカリ1、2、3を選択時。2019年3月現在（当社調べ）

### 1Lあたり、わずか約10円

水道水から作るのでペットボトルやウォーターサーバーの水と比較しても断然お得です。

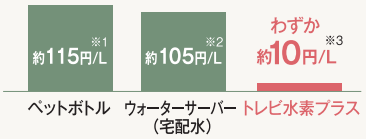


※1 ペットボトル：2Lペットボトルを購入した場合 ※2 ウォーターサーバー：毎日のレンタル料とボトル（12L入）を月4本使用した場合（電気代を除く）※3トレビ水素プラス：1日20Lの使用、本体を5年間使用した場合（本体代金、水道代、電気代、カートリッジ代含む）

### さらに、捨て水ゼロモードで節水

水道のコックを締めて30分以内は捨て水することなくご使用できます。

### オートパワーオフ機能で省エネ

使用30分後に自動でパワーオフモード（待機モード）になり電気のムダ使いを防ぎます。

## フジ医療器だからこそできる進化した「高効率ダブル電解槽」

### 優れた浄水能力と10枚の電極で高水素濃度の電解水を生成

フジ医療器がトレビシリーズを1989年に発売してから30年。
FWH-10000は従来の電解槽（5枚電極）に加えて、
新型水素電解槽（5枚電極）を搭載し、さらにパワーアップ。
溶存水素濃度1300ppb※3のアルカリイオン水の生成を実現しました。

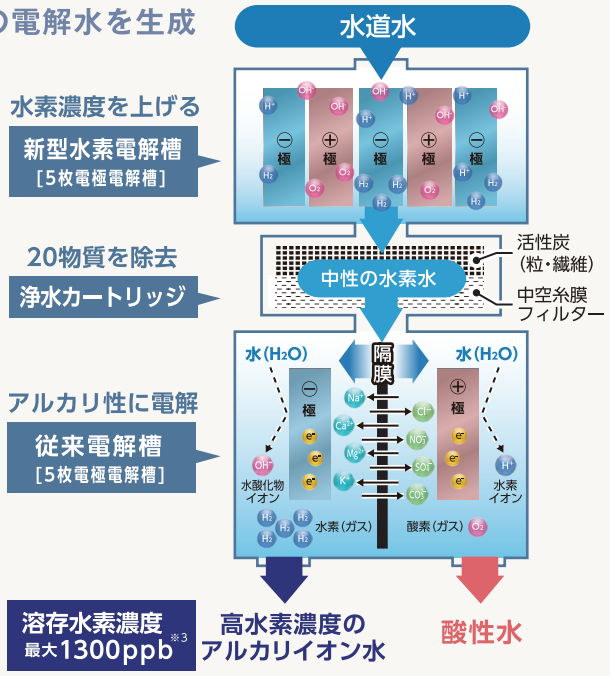


**優れた浄水能力** JIS指定17物質※1+3物質※2を除去

### ORP値はトレビシリーズ過去最高の還元力

ORP（酸化還元電位）とは、物を酸化および還元させる電気的エネルギーの指標。

プラスの値が高いほど酸化する力が強くマイナスの値が低いほど還元する力が強い

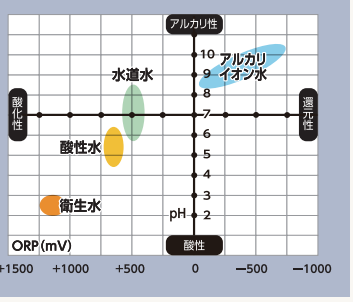


pHが上がるとORP値は下がる傾向にありますが、地域・水質・水圧・水温によって変化します。

※1《JIS規格指定17物質》①遊離残留塩素 ②濁り ③総トリハロメタン ④クロロホルム ⑤ブロモジクロロメタン ⑥ジブロモクロロメタン ⑦ブロモホルム ⑧テトラクロロエチレン ⑨トリクロロエチレン ⑩CAT(農薬) ⑪2-MIB(カビ臭) ⑫溶解性鉛 ⑬ジェオスミン ⑭陰イオン界面活性剤 ⑮フェノール類 ⑯ベンゼン ⑰シス,トランス1,2ジクロロエチレン ※2《浄水器協会自主規格3物質》①鉄(粒子状鉄) ②アルミニウム(中性) ③PFOS及びPFOA
※3 溶存水素計 東亜ディーケーケー製DH-35Aによる測定値。溶存水素濃度は水質によってばらつくことがあります。他の測定器では異なる数値が表示されることがあります。

# TREVI+H2 FWH-10000 アルカリイオン整水器S2

トレビ水素プラス

［管理医療機器］医療機器認証番号 231AKBZX00005000

## 仕様

●本体寸法／幅 25.5× 奥行 14.2× 高さ 32.4cm
●質量／約4.1kg（浄水時 約5.1kg）
●定格／ AC100V（50/60Hz）
●消費電力／約220W（待機時：約0.5W）
●電源コード／ 2.5m
●給水接続／レバー切替
●給水方式／吐水蛇口分岐栓
●本体通水可能水圧（動水圧）／約70～500kPa
●使用可能水道管圧力（静水圧）／約70～750kPa
●電解
＜電解能力切替＞
アルカリイオン水３段階＋強アルカリイオン水1段階、
酸性水1段階、衛生水1段階
＜処理水量＞
［アルカリ 1.2.3 動水圧100kPa の場合］
吐水量（約）／アルカリイオン水：2.38L ／分
排水量（約）／酸性水：0.12L ／分
［アルカリ 1.2.3 動水圧 350kPa の場合］
吐水量（約）／アルカリイオン水：5.5L ／分
排水量（約）／酸性水：0.29L ／分

●浄水カートリッジ（FW-20CM）
＜ろ過材料＞
中空糸膜、粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
＜ろ過能力＞
遊離残留塩素 約 8,000L※1
濁り 約 8,000L※2
総トリハロメタン 約 8,000L※1
など、JIS 規格指定 17 物質＋浄水器協会
自主規格３物質を除去
※1：家庭用浄水器試験方法（JIS S3201）に準拠した試験で除去率 80%の値
※2：家庭用浄水器試験方法（JIS S3201）に準拠した試験でろ過水量 50%の値

＜カートリッジの寿命＞
・使用可能通水量：8,000L
・使用可能日数：730 日

メーカー希望小売価格：308,000 円(税込)
標準工事費：15,400 円(税込)
【追加部品が必要な場合は別途費用がかかります。】

［専用カートリッジ］
専用浄水カートリッジ
FW-20CM
13,200円(税込)

［別売品・消耗品］
・pH測定液
・衛生水生成用食塩
・衛生水スプーン

FWH-10000
JAN:4951704417570

［同梱付属品］

・分岐栓
・分岐栓取付け用付属品
・pH 測定液セット
・カートリッジ交換シール
・ホース固定バンド　・吸盤

・衛生水カートリッジ

食塩計量用衛生水スプーン付
・衛生水生成用食塩
・デリバリーパイプ

## キッチン環境に合わせて取り付けできます

付属の分岐栓を取り付けた場合

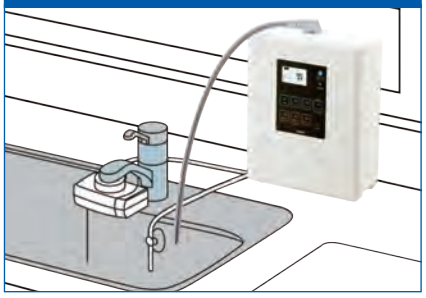

別売品　シングル分岐栓

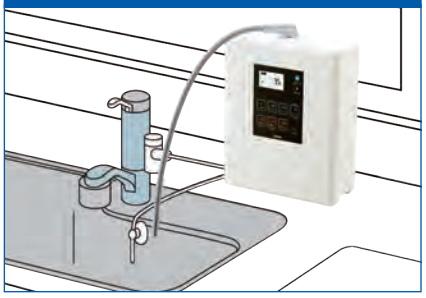

シャワー式などで付属の分岐栓が取り付けできない場合

## 3段階のレバーで切替可能

切替レバーを使えば、用途に応じて「アルカリイオン水・浄水」「水道水のシャワー」「水道水の原水」の3段階に切替することができます。

※熱水（50℃以上）が流れると自動的に分岐栓の熱水吐水口から吐水され、本体への流入を防ぎます。

**安全に関するご注意**

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。■アルカリイオン整水器のご注意●腎疾患（腎不全、カリウム排せつ障害など）の方はアルカリイオン水を飲用しないでください。●アルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。①医薬品をアルカリイオン水で服用しないでください。②飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師にご相談ください。●次の方はご使用前に医師にご相談ください。①持病のある方または身体の弱っている方。②腎臓に障害のある方及び、身体に異常を感じている方。③医師の治療を受けている方。●初めてご使用になる場合、pH値が中性に近い水から少量ずつ（コップ1～2杯）、2週間程度アルカリイオン水になれていただき、順次pH値を上げてご使用されることをおすすめします。●アレルギー症の方は発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。●次の方は酸性水を使用する前に医師にご相談ください。①肌の弱い方。②アレルギー体質の方。●酸性水を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師にご相談ください。●本カタログ掲載商品は日本国内でご使用ください。●飲用に合格した水を使用してください。●元止め式瞬間湯沸器には使用しないでください。

**使用上のご注意**　●水道法の水質基準に不適合な原水は処理できません。●硬水を軟水に変えることはできません。●地域によってカートリッジ寿命に差があります。

## ご使用にあたって

◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

## お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル 0120-027-612　受付：平日9：00～17：30（土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く）

Web　www.fujiiryoki.co.jp
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号　06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、
お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

**ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて**

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

**フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！**　フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop


美と健康の総合メーカー
株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp


このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…


●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2025年7月現在のものです。



25.07.2M.GA.AI.G 注文No.1645